


Blutentnahme und Transport des QuantiFERON®-TB Gold Plus IT Test

Blutentnahme


- Sie erhalten 4 Röhrchen für eine hohe Genauigkeit
- Bitte Entnahme nicht direkt nach einer großen Mahlzeit, kleines Frühstück ist erlaubt
- Entnehmen Sie von jedem Patienten je 1 ml venöses Blut in jedes der vier QFT-Plus Blutentnahmeröhrchen

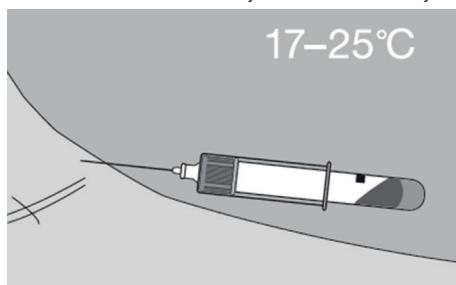

Bei der Blutentnahme sollten die Röhrchen eine Temperatur von 17-25 °C aufweisen.

Da die 1-ml-Röhrchen das Blut relativ langsam aufnehmen, belassen Sie das Röhrchen nach dem scheinbaren Erreichen des Füllstands bitte noch **2-3 Sekunden** auf der Nadel. Wird bei der Blutentnahme die schwarze Markierungslinie am Rand des Etiketts nicht erreicht, entnehmen Sie bitte eine neue Blutprobe.

- Unmittelbar nach dem Befüllen der Röhrchen schwenken Sie diese bitte 10 x gerade fest genug, um sicherzustellen, dass die Innenwand der Röhrchen ganz mit Blut bedeckt ist, damit sich die Antigene aus der Wandbeschichtung lösen können

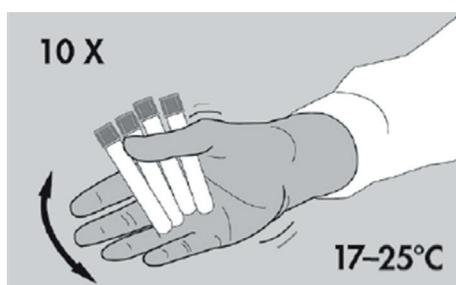

Wichtig:

Zu heftiges Schütteln kann den Gelpfropf zerstören und zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

- Beschriften Sie alle 4 Röhrchen mit den Patientendaten (Name, Geburtsdatum)

Transport

- Die Blutproben müssen schnellstmöglich (innerhalb von 16 Stunden nach der Blutentnahme) im auswertenden Labor bei 37 °C inkubiert werden
- Senden Sie die Röhrchen bei 17-27 °C ins Labor
- Wenn längere Verzugszeiten unvermeidlich sind, kommt auch eine Bebrütung in der Praxis mit anschließender Zentrifugation in Frage. Bitte halten Sie dazu Rücksprache mit dem Labor



MEDIZINISCHES LABOR
BREMEN

Ein Service Ihres Laborpartners
Medizinisches Labor Bremen

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12
28357 Bremen
Telefon: 0421 20720
www.mlhb.de